

2014年10月吉日

お得意様各位

株式会社コスミックコーポレーション
営業部
〒112-0002 東京都文京区小石川 2-7-3 富坂ビル
電話 03-5802-5971

ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット仕様変更に関する情報提供

拝啓 時下ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、弊社製品「ミエリン塩基性蛋白 ELISA キット」におきまして、下記の通り、仕様を変更致します。つきましては仕様変更前後のキットロット相関試験結果をご報告致します。

引き続きのご指導と、より一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記


《変更内容》

MBP 標準液の濃度及び希釈倍率の変更

変更前	変更後
MBP 標準液 (1 μ g/mL)	MBP 標準液 (5 μ g/mL)
使用時希釈倍率・・・500 倍	使用時希釈倍率・・・2500 倍

※ロット MBP0322 以降

《相関図》

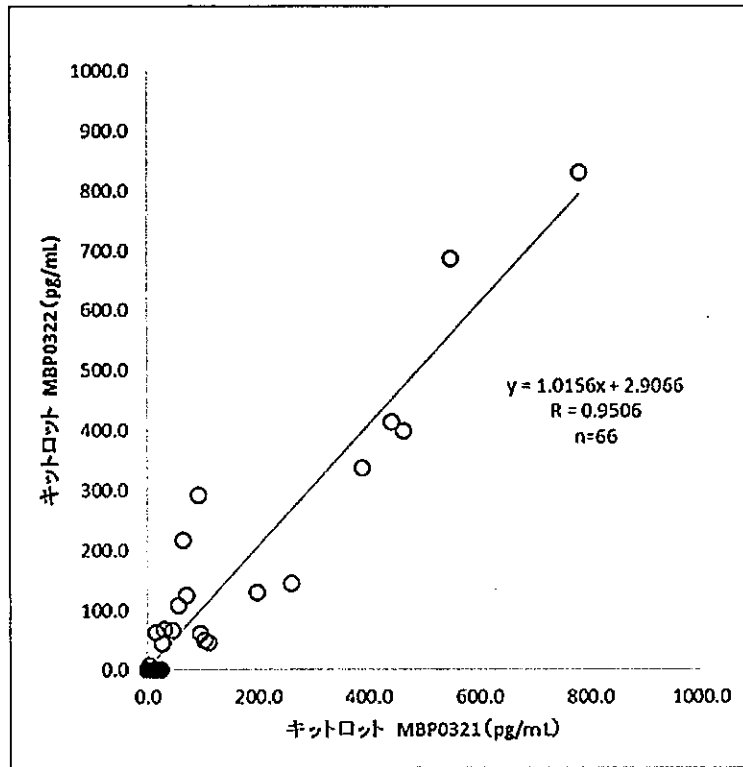

《相関データ》

	MBP0321	MBP0322		MBP0321	MBP0322
1	548.1	686.4	34	0.0	0.0
2	95.4	61.4	35	4.0	0.0
3	389.2	336.2	36	1.6	0.0
4	102.7	49.1	37	8.0	0.0
5	9.9	0.0	38	10.2	0.0
6	463.0	399.2	39	29.8	67.2
7	441.4	412.8	40	18.5	0.0
8	198.6	130.0	41	20.2	0.0
9	779.6	830.0	42	0.0	0.0
10	260.9	144.5	43	0.0	0.0
11	110.5	46.0	44	1.6	0.0
12	92.7	291.2	45	0.0	0.0
13	65.3	215.9	46	1.1	0.0
14	55.5	107.8	47	0.9	0.0
15	26.5	44.9	48	25.6	0.0
16	44.7	65.1	49	23.5	0.0
17	70.1	124.9	50	0.0	0.0
18	0.0	0.0	51	0.0	0.0
19	62.4	216.5	52	0.0	0.0
20	15.8	62.4	53	0.0	0.0
21	10.7	0.0	54	0.0	0.0
22	0.4	0.0	55	0.0	0.0
23	0.0	0.0	56	0.9	0.0
24	15.3	0.0	57	0.0	0.0
25	12.7	0.0	58	0.0	0.0
26	3.0	6.6	59	0.0	0.0
27	3.5	0.0	60	0.0	0.0
28	4.3	0.0	61	0.0	0.0
29	4.5	0.0	62	0.0	0.0
30	0.7	0.0	63	3.5	0.0
31	0.0	0.0	64	0.0	0.0
32	0.0	0.0	65	0.0	0.0
33	5.6	0.0	66	0.4	0.0

以上